


当院では


GE社製16列マルチスライスCTを  
導入しています

## Brivo CT385

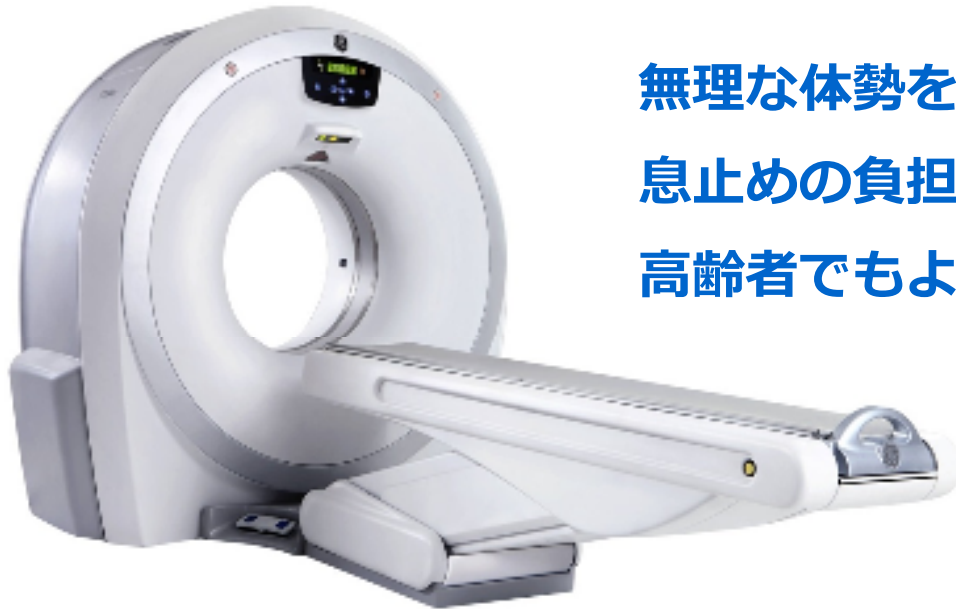


無理な体勢を極力少なく  
息止めの負担をより軽く  
高齢者でもより良い画質で

### ■ 臨床画像例

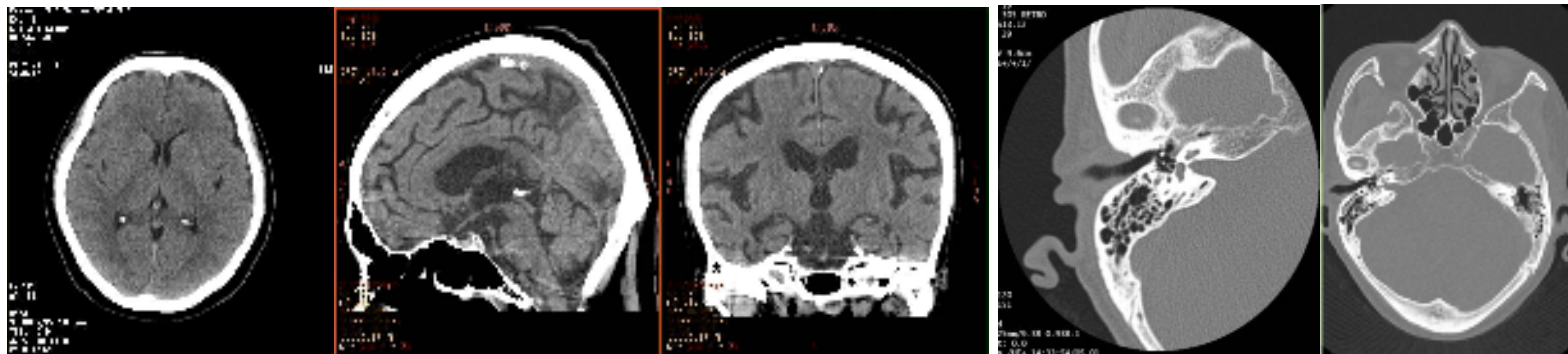


頭部ルーチン撮影画像から多断面再構成可能

0.625mmで耳小骨撮影

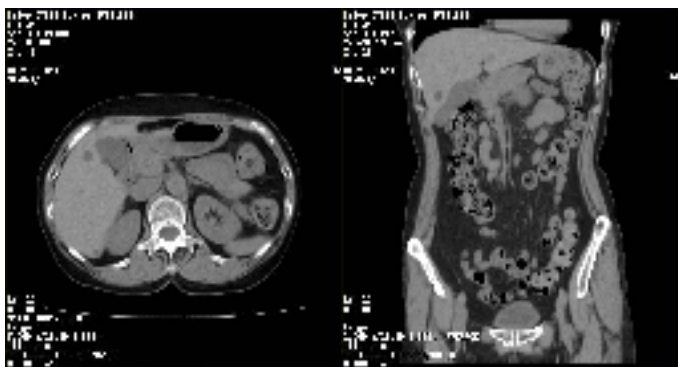

腹部40cm 14秒息止め撮影 冠状断再構成

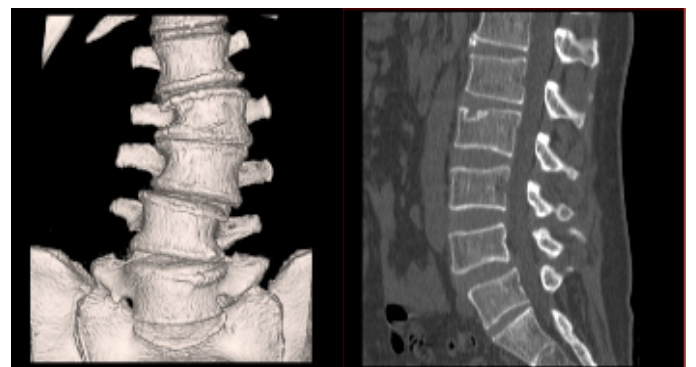

0.625mmで腰椎撮影 3D画像・MPR処理